



ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** DE LA **licitación Pública** NO. **LPA-926049950-011-2020** DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EMITIDA EL DÍA **11 DE JUNIO DE 2020**, RELATIVA A LA **ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO, BANCO DE SANGRE Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL AÑO 2020**, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

En **Hermosillo Sonora**, siendo las **12:00** horas del día **19 de junio de 2020**, fecha y hora fijada para celebrar la junta de aclaraciones de la licitación anteriormente citada, se reunieron en **la sala de juntas de la Coordinación de Licitaciones de ISSSTESON**, solo servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento, lo anterior de conformidad con lo señalado en el numeral 3, de las bases de licitación que determina las medidas relacionadas con la Contingencia sanitaria ante el brote de COVID- 19, las respuestas emitidas en la presente acta, serán publicadas en Compra NET Sonora.

En representación del **Lic. Jorge Eduardo González Madrid**, Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, preside el acto el **Lic. Norberto Salazar Valle**, Titular de la Coordinación de Licitaciones, quien exhibe oficio de designación vigente de fecha de 05 julio de 2019, mismo que lo faculta para presidir el presente acto.

ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE.

I.- Para las pruebas de Serológicas se solicita que el proveedor adjudicado cumpla con NOM-253-SSA-01-2012, que requiere realizar **CONTROLES POSITIVOS DEBILES** de todas las serologías que se realizan en el banco de sangre (HIV 1 y 2, Chagas, HeoBs y core, HepC). Por lo tanto se solicita por normas se proporcionen estos reactivos, ya que la falta de ellos es auditable por el CETS Y CNTS.

II.- Se deberá agregar como un insumo más en el Banco de sangre en el sistema Inmunohematología ID-Diluent 1 solución de bromelina modificada para la suspensión de células rojas y pruebas de enzimas (ID-n 05751). Cantidad 4 frascos, numero de catálogo 009180



PREGUNTAS

AXMILAB S.A. DE C.VDOCUMENTO 5.
PROPUESTA TÉCNICA

En el Apartado de DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, dice:

El licitante presentará copia del registro sanitario a nombre del fabricante o distribuidor o filial en México de los equipos en comodato ofertados para la presentación del servicio derivado de las adquisiciones relacionadas con el objeto de la presente licitación.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante se nos permita realizar la entrega de los registros sanitarios en Formato Digital en CD o en Memoria USB. ¿Se Acepta?

R.- Si, se acepta se entregue en memoria USB, pero deberán ser tres USB que contenga dicha información completa.

ANEXO No. 5.12
REQUERIMIENTO TECNICO

Nombre Genérico: EQUIPO PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES DE BANCO DE SANGRE
SUBPARTIDA 012

DESCRIPCION SOLICITADA
EQUIPO (S) AUTOMATIZADO (S) COMPLETAMENTE

Solicitan: Principio de medición quimioluminiscencia.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar un equipo con principio de medición Electroquimioluminiscencia, esto sin alterar los estándares de calidad de sus resultados. ¿Se acepta?

R.- Si, se acepta siempre y cuando se apegue a los estándares de calidad especificados por la NOM-253-SSA01-2012

Solicitan: Velocidad de procesamiento mínimo de 100 pruebas por hora

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que procese hasta 90 pruebas por hora sin que esto afecte la productividad de su Banco ya que de acuerdo a las cantidades solicitadas usted estaría procesando aproximadamente 100 pruebas diarias, lo cual equivaldría en un turno de 4 horas a 25 pruebas por hora ¿Se acepta?

R.- Si, se acepta la propuesta de un equipo que procese hasta 90 pruebas por hora.



Solicitan: 25 reactivos a bordo refrigerados

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con área para 18 posiciones de reactivos a bordo y temperatura controlada, ya que debido a la productividad y el equipo ofertado (90 pruebas por hora) no habría necesidad de dejar los reactivos a bordo, puesto que estos serían utilizados sin necesidad de sacarlos a refrigeración, ¿Se acepta?

R.- Si, se acepta un equipo con área para 18 posiciones de reactivos.

Nombre Genérico: EQUIPO PARA SISTEMA HEMATOLOGICO DE BANCO DE SANGRE

SUBPARTIDA 013

DESCRIPCION SOLICITADA

TOTALMENTE AUTOMATIZADO

INCLUYE FORMULA ROJA, BLANCA, DIFERENCIAL COMPLETO, CUENTA DE PLAQUETAS, HCM, VCM, RDW, PLAQUETOCRITO, PDW, ETC

PARÁMETRO MINIMO 21

Solicitan: VELOCIDAD MÍNIMA DE PROCESO: 80 P/H

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que sea capaz de procesar 60 pruebas por hora, sin que esto afecte la productividad de su Banco ya que de acuerdo a las cantidades solicitadas usted estaría procesando aproximadamente 20 pruebas diarias, ¿Se acepta?

R.- Si, se acepta un equipo que sea capaz de procesar 60 pruebas.

Solicitan: METODOLOGIA DE LECTURA: OPTICA MUTIANGULOS

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar un equipo con principio de: medición Citometría de flujo fluorescente: WBC, DIFF, RET, IRF, IPF

• Método de impedancia con enfoque hidrodinámico:

RBC, HCT

• Método SLS-hemoglobina libre de cianuro: HGB esto sin alterar los estándares de calidad de sus resultados. ¿Se acepta?

R.- Si, se acepta el método SLS-hemoglobina libre de cianuro. Sin que afecte los estándares de calidad.

Solicitan: QUE INCLUYA CONTEO DE PLAQUETAS POR METODOLOGIA OPTICA PARA EVITAR INTERFERENCIA DE VARIANTES DE CORRIENTE ELECTRICA

Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar un equipo con principio de medición Citometría de flujo fluorescente que incluya recuento de reticulocitos y plaquetas ópticas, ¿Se acepta?

R.- Si, se acepta un equipo con principio de medición por citometría de flujo fluorescente que incluya reticulocitos y plaquetas óptimas.




INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

En el ANEXO No.1, PARTIDA #2, CÓDIGO 01152 SOLICITAN: "Bolsa Cuádruple para Extracción de Sangre". Solicitamos respetuosamente a la convocante nos confirme si la configuración de bolsa Cuádruple es Top and Top(T&T) ó Top and Bottom(T&B), favor de aclarar.

R.- Se solicitan bolsas cuádruples de extracción Top and Bottom.


Una vez presentadas las aclaraciones por parte de la convocante, y después de haber dado respuestas a las preguntas presentadas por los interesados en esta licitación en tiempo y forma como lo establecen las bases de licitación, se clausura el acto de junta de aclaraciones a las 13:10 horas del día 19 de junio de 2020.

POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

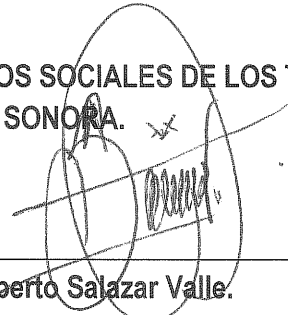

Lic. Norberto Salazar Valle.
Jefe de la Coordinación de licitaciones.


SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

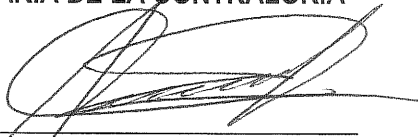

C.P. Francisco Arturo Cornidez Armendáriz.
Auditor del Órgano Interno de Control.

SECRETARIA DE HACIENDA

No se presentó



Q.B. Amada del Carmen Gortáez Castro.
Coordinación de Laboratorios de ISSSTESON.

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE	FIRMA